



Toute utilisation, reproduction, diffusion, publication ou retransmission des contenus de cette présentation, totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation préalable et écrite de PHAST.



Catalogue d'interopérabilité des dispositifs médicaux

Agathe DALIN
Etienne DUBOURDIEU



PHAST

PHAST

Qui sommes-nous ?



PHAST

Spécialisée dans
les échanges de
données de santé



Contribue à
l'élaboration des
standards
d'interopérabilité
nécessaires à
l'échange de ces
données





PHAST assure leur
déploiement dans
des catalogues
d'interopérabilité CIO



Catalogues
intégrés dans les
logiciels des
établissements de
soins



CIO & SIH

- ✓ Catalogues de codifications et terminologies standards
- ✓ Données partagées entre toutes les applications informatiques du circuit des médicaments et DM
- ✓ Contribuent à l'interopérabilité des applications

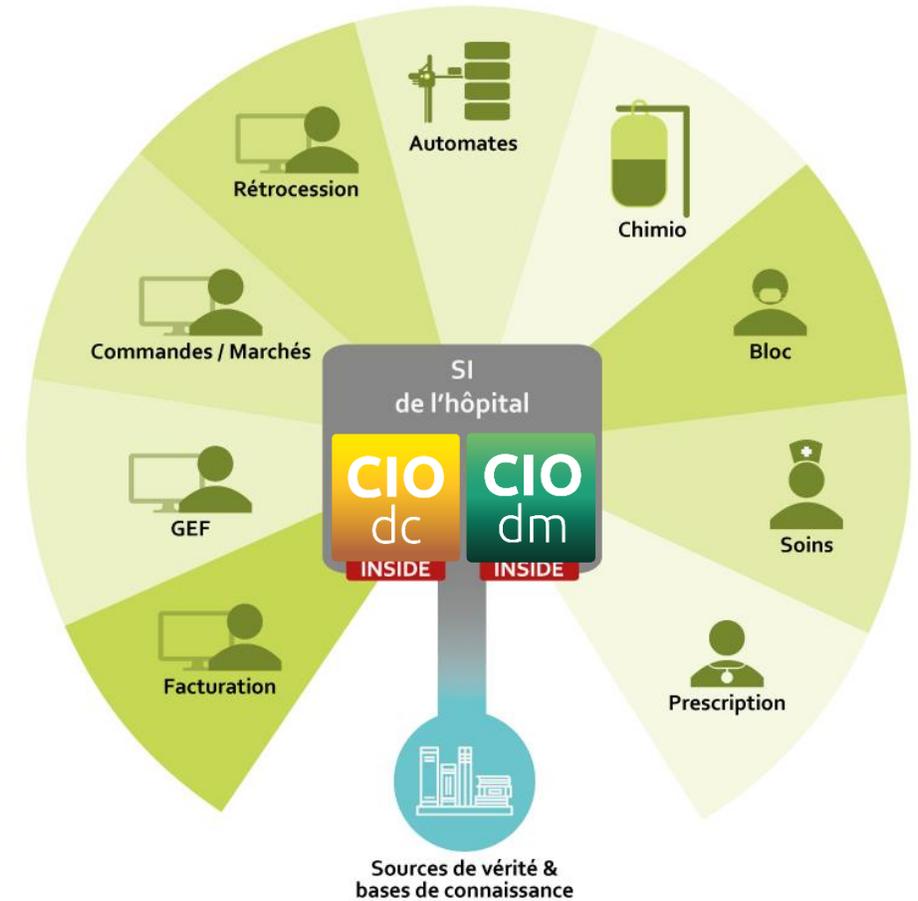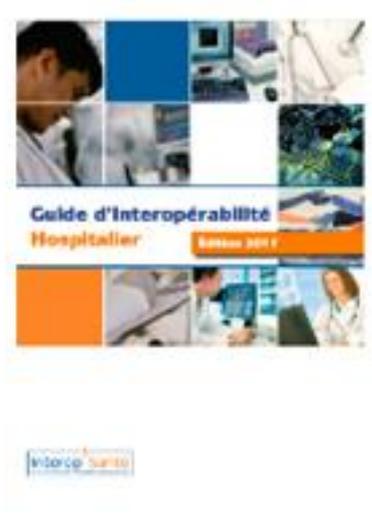

CIO & GHT

- ✓ Mise en œuvre d'un système unique de gestion des pharmacies au sein d'un GHT

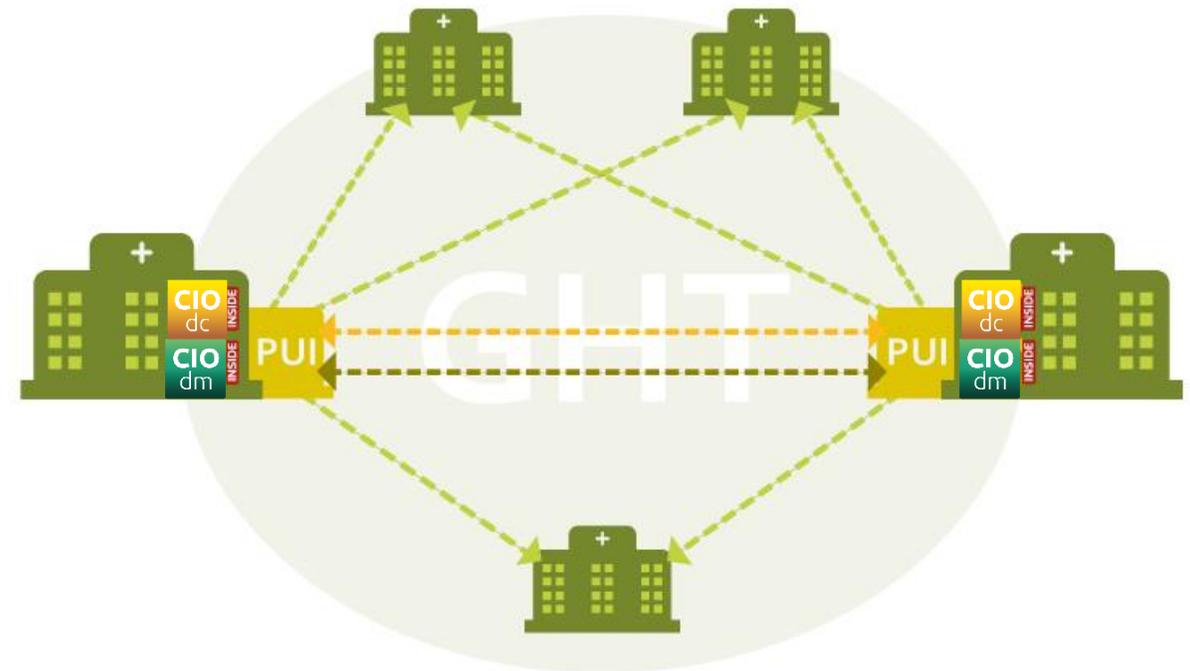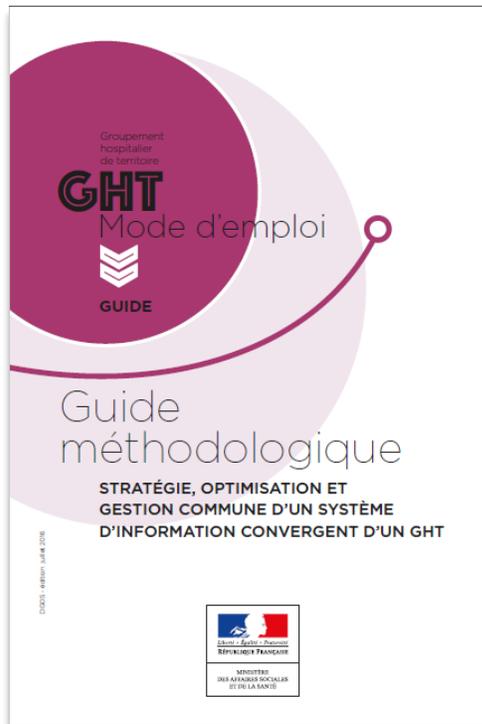

Déploiement



600

établissements,
utilisateurs (CHU,
CH, ESPIC, cliniques,
CLCC, CHS, EHPAD...)

Licences CIOdm

300 Etablissements

Dont 24 CHU

[Lien vers la liste des établissements](#)



Périmètre et contenu de CIOdm



CIO
dm

>1,9 million de DM

>95% des DM du marché français


Tous les produits répondant à la définition réglementaire d'un DM

- ✓ Implantables
- ✓ Consommables
- ✓ Stériles
- ✓ Non stériles

- × DMDIV
- × Cosmétiques
- × Médicaments
- × DADFMS

Découvrir CIOdm

- Visionneuse en ligne phast.fr
- Moteur de recherche multicritères
- Consultation gratuite
- [Guide utilisateurs](#)

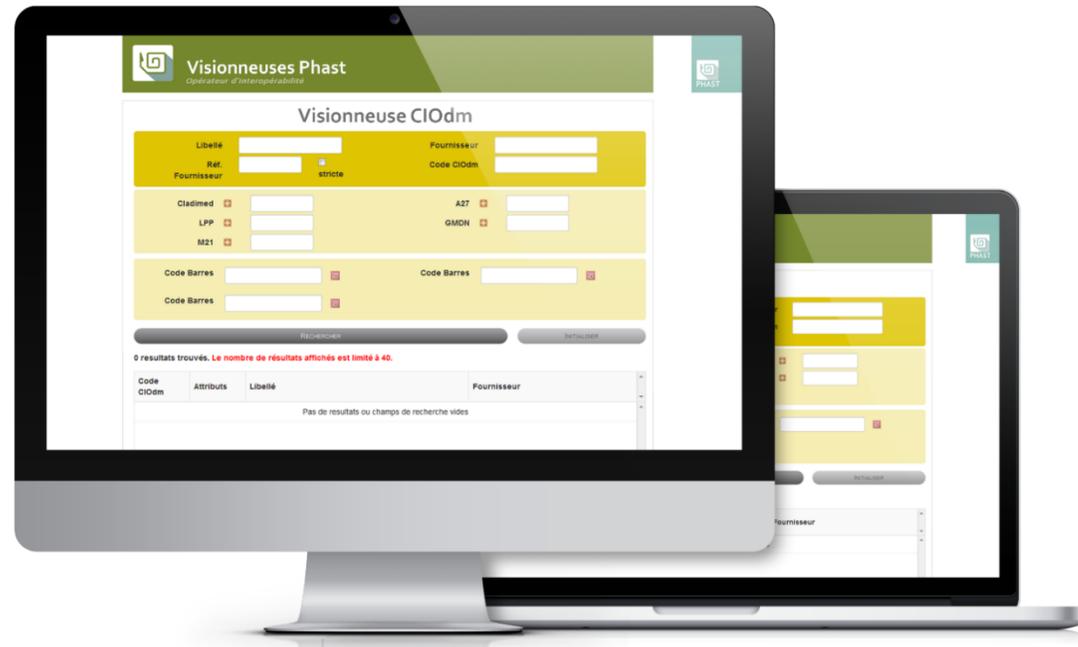

Contenu



CODE CIOdm (ArtIdCIO)

DONNEES
D'IDENTIFICATION DU DM

DONNEES DE
CLASSIFICATIONS DU DM

DONNEES LIEES AU
REMBOURSEMENT DU DM

DONNEES SUR LES
PROPRIETES DU DM

Code CIOdm CU0R792    Fiche créée le 27/08/2017

Libellé Stimulateur cardiaque EDORA 8 DR-T ProMRI (télécardiologie) Uni/bipolaire DDDR connexion CLS-IS1

CLADIMED C50FA04 STIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE DOUBLE CHAMBRE

Hierarchie »

M21 602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS

N.C.H.F.S. 18.22 DISPOSITIFS MEDICAUX POUR CARDIOLOGIE

Achat DC50FA04 STIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE DOUBLE CHAMBRE

GMDN 47265 Stimulateur cardiaque implantable à chambre double, réactif à la fréquence

Définition GMDN »

© Copyright GMDN Agency 2018. Copyright Statement

LPP Depuis le 17/07/2017

3428900 STIMULATEUR CARDIAQUE DOUBLE CHAMBRE FREQ. ASSERV., BIOTRONIK, EDORA 8 DR-T

Prix : 3281,79 Coefficient : 1 Remboursable Hors-GHS

Indication(s) structurée(s) LPP

- 54 - Dysfonction du nœud sinusal avec insuffisance chronotrope associée soit à des anomalies de la conduction auriculo-ventriculaire, soit à une maladie rythmique atriale
- 55 - Bloc auriculo-ventriculaire du 2e ou du 3e degré nécessitant une stimulation ventriculaire permanente ou intermittente (si la conduction auriculo-ventriculaire est préservée) chez le patient ayant une insuffisance chronotrope, lorsque le maintien d'une activité physique est possible, et si l'oreillette est stimuable de façon prédominante


Historique LPP et Descriptif AMELI »

Conditionnement(s) 1. Pièce

BIOTRONIK France (Distributeur)

Référence fournisseur : 407145 Code-barres : 04035479147648 (GTIN) GUID : ▼

Sources

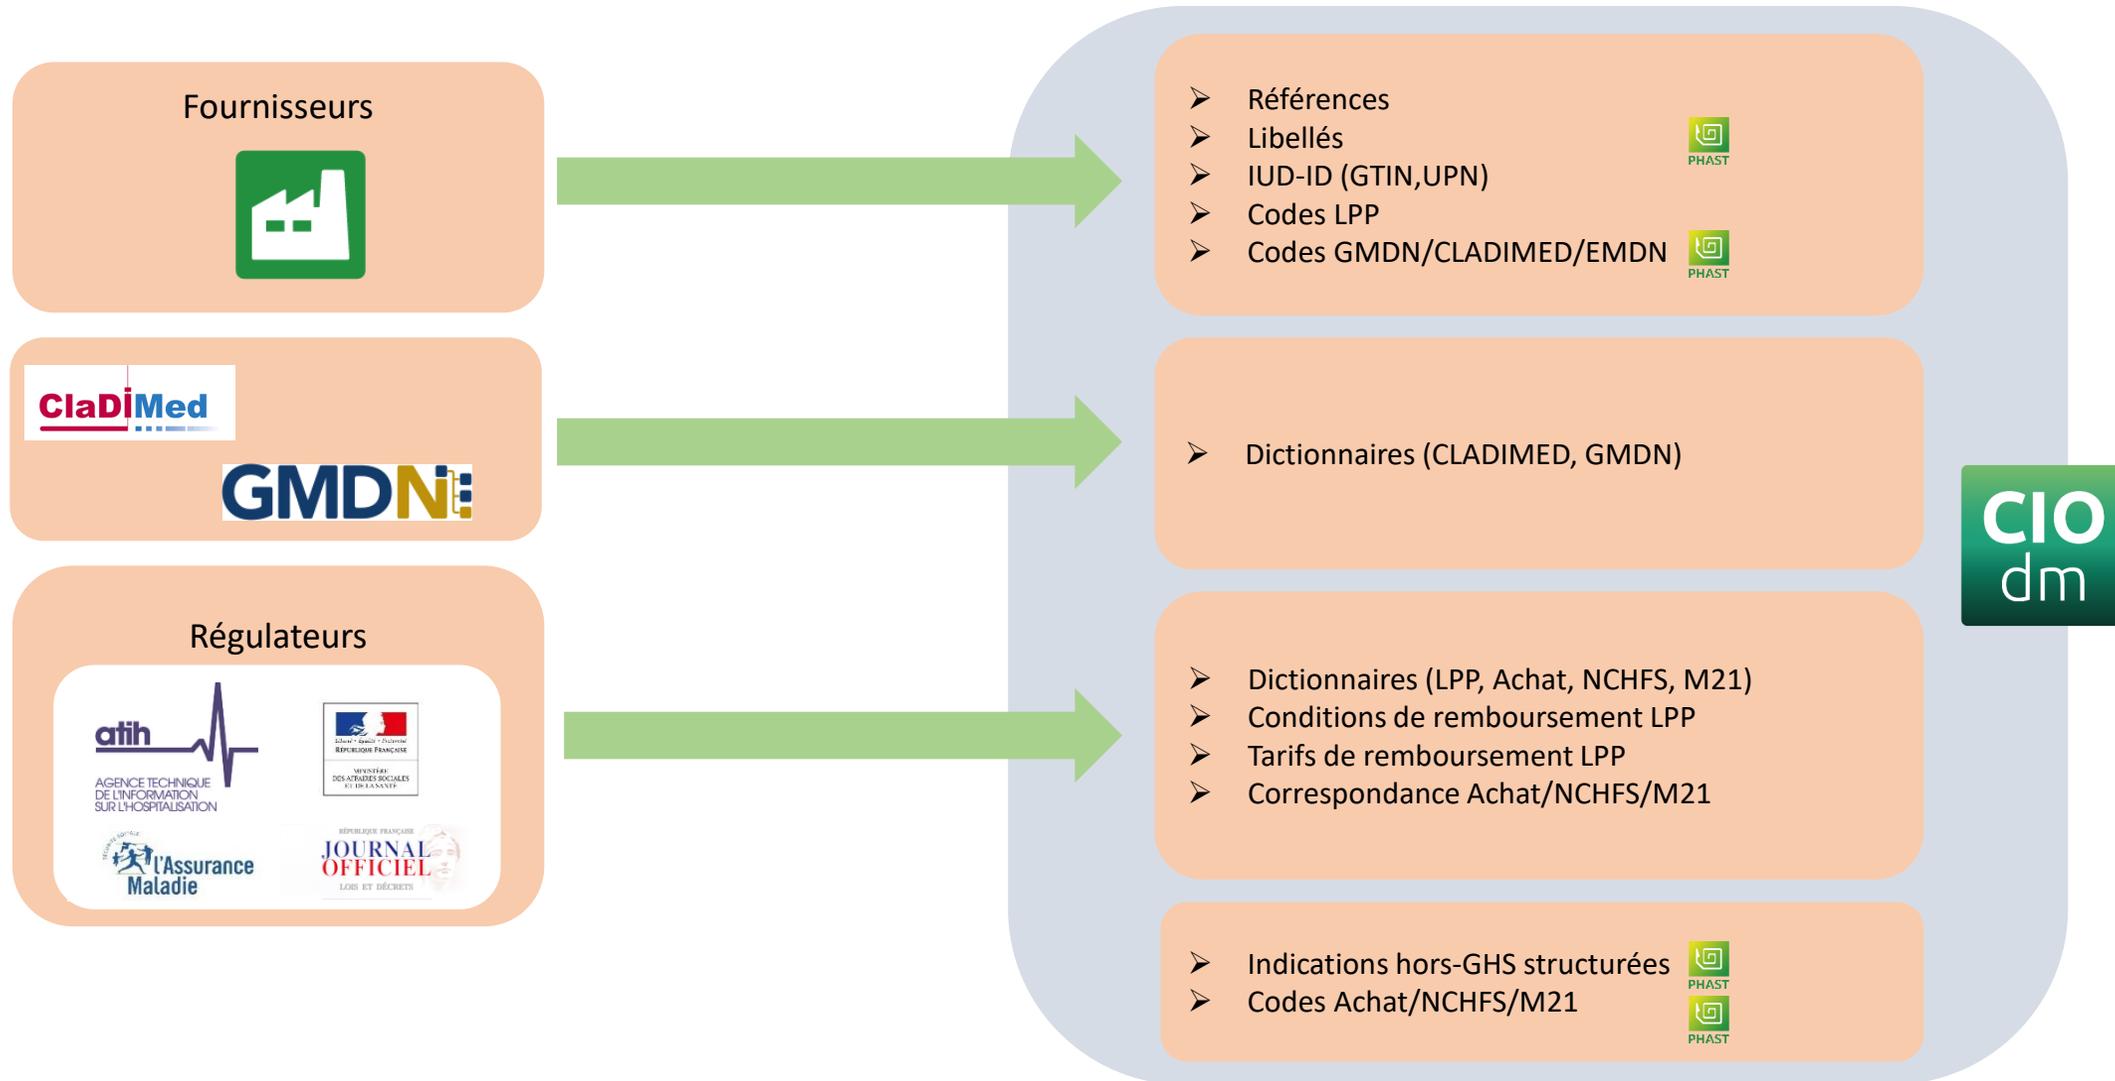

Traçabilité sanitaire

Décret du 29
novembre 2006

Arrêté du 26
janvier 2007

Note
d'information
du 27 mars 2019

Règlement (UE)
2017/745


Arrêté du 8
septembre 2021

Cadre réglementaire

- Traçabilité sous la responsabilité de la direction, PUI et services utilisateurs
- Pour tous les **DMI** sauf ligatures, sutures et dispositifs d'ostéosynthèse
- Traçabilité réalisée **en temps réel / à chaque étape / par chaque acteur**
- Traçabilité **partagée** (respect du cadre d'interopérabilité des SIS)
- Enregistrement de l'**IUD** par lecture des **codes-barres**



Synthèse

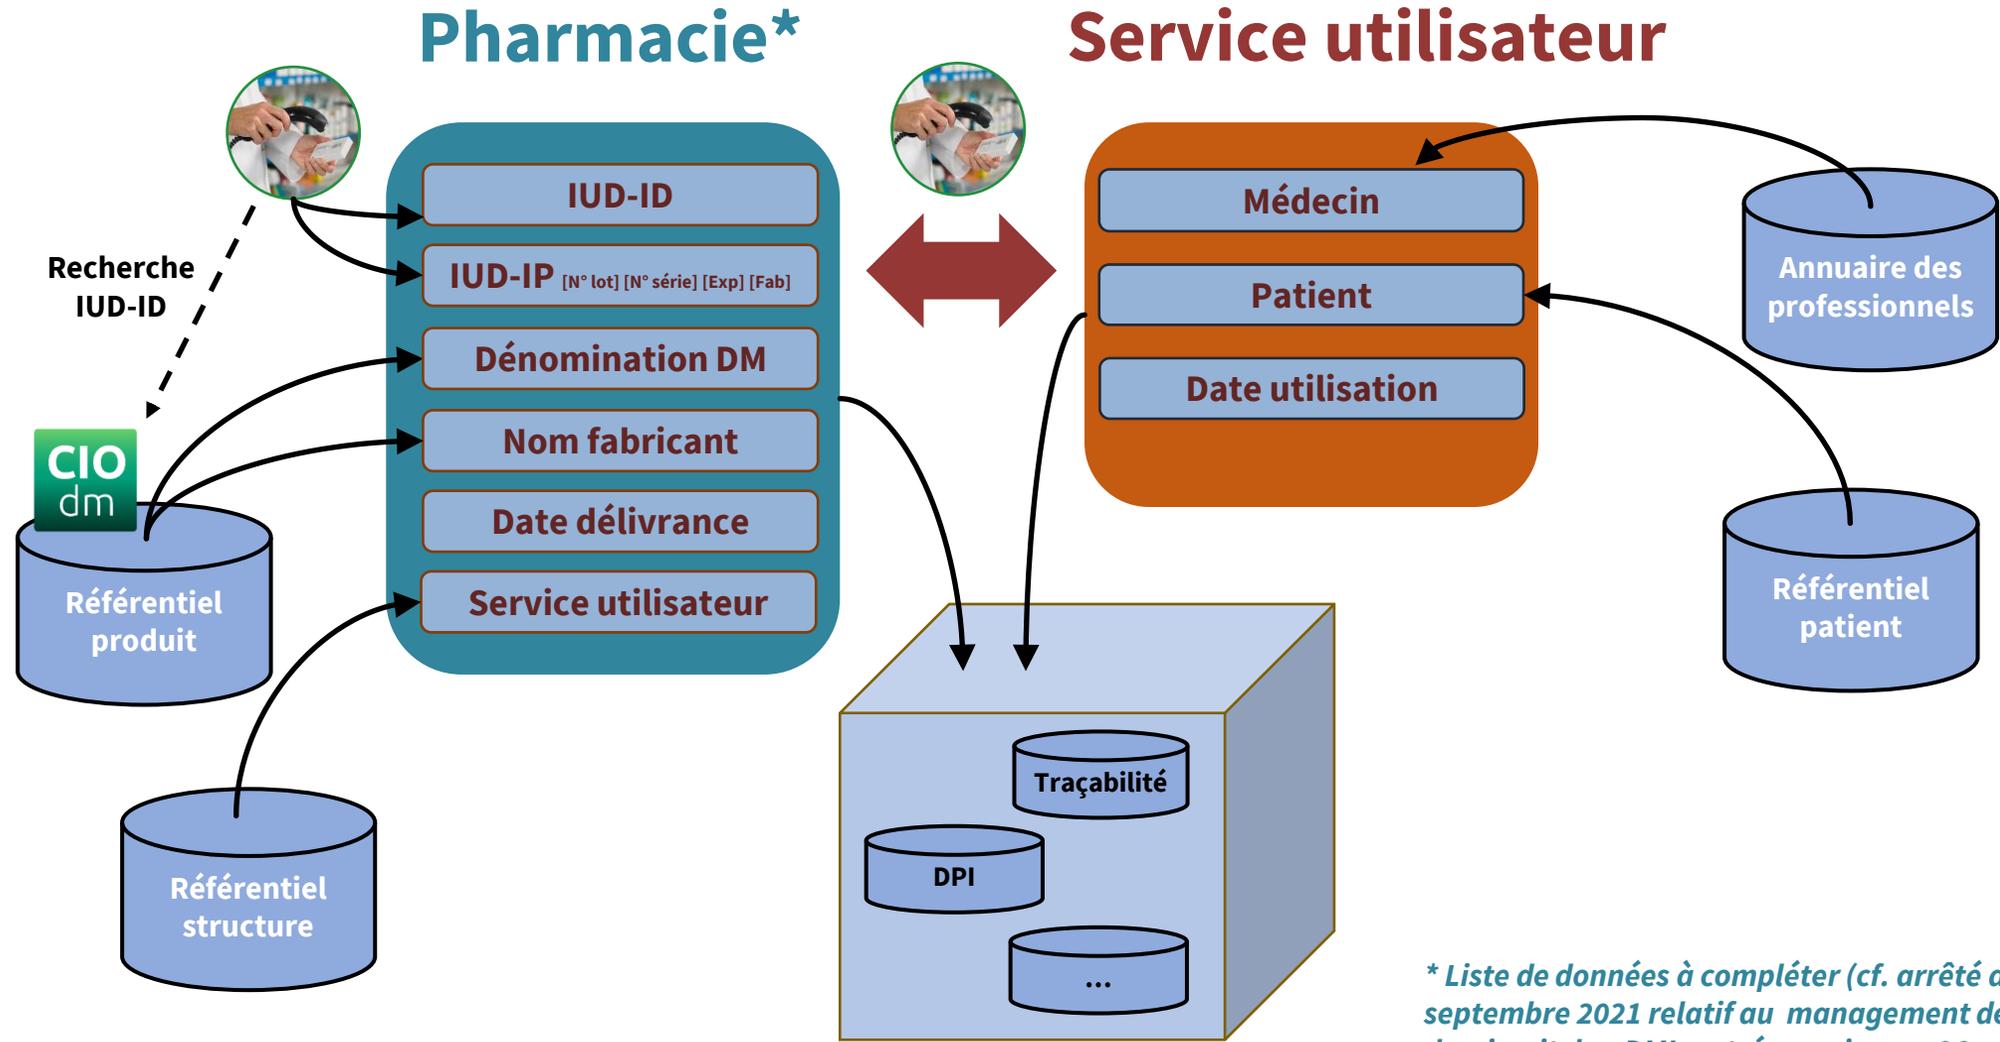

* Liste de données à compléter (cf. arrêté du 8 septembre 2021 relatif au management de la qualité du circuit des DMI, entrée en vigueur 26 mai 2022)

IUD-ID dans CIOdm

>70% des DM implantables sont déjà associés à au moins un IUD-ID (GTIN ou UPN) dans CIOdm

SPINEART SA (Titulaire du Brevet)	
Référence fournisseur :	Code-barres :
JUL-OX-32-14-S	07640151087296 (GTIN) IUD-ID
MICROPORT ORTHOPEDICS (Titulaire du Brevet)	
Référence fournisseur :	Code-barres :
KTONP51R	M684KTONP51R1 (UPN) IUD-ID

Traçabilité financière & bon usage

Données LPP



Code CIOdm CU0R792

Libellé Stimulateur cardiaque EDORA 8 DR-T ProMRI (télécardiologie) Uni/bipolaire DDDR connexion CLS-IS1

Code LPP 3428900

Indications structurées

Historique du code LPP

Indications non structurées

Période de rattachement au code CIOdm

Libellé LPP

CAQES

Tarifs LPP

Statut Hors-GHS

Lien vers Ameli

Depuis le 17/07/2017

3428900 STIMULATEUR CARDIAQUE DOUBLE CHAMBRE FREQ. ASSERV., BIOTRONIK, EDORA 8 DR-T

Prix : 3352,15 Coefficient : 1 Remboursable Hors-GHS

Indication(s) structurée(s) LPP

- 54 - Dysfonction du nœud sinusal avec insuffisance chronotrope associée soit à des anomalies de la conduction auriculo-ventriculaire, soit à une maladie rythmique atriale
- 55 - Bloc auriculo-ventriculaire du 2e ou du 3e degré nécessitant une stimulation ventriculaire permanente ou intermittente (si la conduction auriculo-ventriculaire est préservée) chez le patient ayant une insuffisance chronotrope, lorsque le maintien d'une activité physique est possible, et si l'oreillette est stimuable de façon prédominante

Historique LPP et Descriptif AMELI

Date de début	Date de fin	Tarif TTC	Annexe
01/02/2019		3352,15	Remboursable Hors-GHS
17/07/2017	31/01/2019	3431,29	Remboursable Hors-GHS

Descriptif AMELI

Dispositifs médicaux implantables actifs. Stimulateur cardiaque double chambre fréq. asserv., BIOTRONIK, EDORA 8 DR-T. Stimulateur cardiaque double chambre à fréquence asservie (DDDR) équipé d'un système de télétransmission Home Monitoring, de la société BIOTRONIK France. INDICATIONS PRISES EN CHARGE : Bloc auriculo-ventriculaire du 2e ou du 3e degré nécessitant une stimulation ventriculaire permanente ou intermittente (si la conduction auriculo-ventriculaire est préservée) : - chez le patient ayant une insuffisance chronotrope, lorsque le maintien d'une activité physique est possible, - et si l'oreillette est stimuable de façon prédominante, Dysfonction du nœud sinusal avec insuffisance chronotrope associée soit à des anomalies de la conduction auriculo-ventriculaire, soit à une maladie rythmique atriale. La fibrillation auriculaire chronique et permanente n'est pas une indication de la stimulation double chambre DDD (R). REFERENCES PRISES EN CHARGE - Stimulateur EDORA 8 DR-T (référence : 407145) à connecteur conforme aux normes européennes - Système de télésurveillance incluant : - le transmetteur CARDIOMESSENGER SMART (référence : 401826) - la transmission des données du transmetteur vers le HOME MONITORING SERVICE CENTER - le centre de service HOME MONITORING SERVICE CENTER Les modalités de prescription et d'utilisation sont détaillées dans les conditions générales.

Lien AMELI

2 grands types d'inscription LPP



PHAST

LIGNE GÉNÉRIQUE

Code LPP : 3142930

Désignation : ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT METALLIQUE NU NON RESORBABLE

Dispositifs médicaux implantables. Implants vasculaires. Endoprothèse coronaire dite stent métallique nu non résorbable. La prise en charge est assurée, dans la limite d'une unité par lésion et d'un maximum de deux unités par artère, système de pose compris. La prise en charge est assurée dans les indications suivantes : - sténoses courtes (< 20 mm) des vaisseaux coronaires, quel qu'en soit le diamètre ; - sténoses longues (de 20 à 40 mm) sur des vaisseaux de diamètre supérieur ou égal à 3 mm ; - sténoses de greffons veineux ; - occlusions coronaires totales ; - accidents aigus de l'angioplastie : dissections, occlusions. Dans le cas de dissection occlusive aiguë d'une artère, trois unités au maximum, par artère, peuvent être prises en charge.

Codes LPP individuels

Code LPP : 8113146

Désignation : ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT METALLIQUE NU NON RESORBABLE.BIOSENSORS

Code LPP : 8112780

Désignation : ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT METALLIQUE NU NON RESORBABLE.BOSTON SCI

Code LPP : 8126611

Désignation : ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT METALLIQUE NU NON RESORBABLE.ABBOTT MEDICAL

Code LPP : 8115889

Désignation : ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT METALLIQUE NU NON RESORBABLE.B.BRAUN MEDICAL

Dispositifs médicaux implantables. Implants vasculaires. Endoprothèse coronaire dite stent métallique nu non résorbable. La prise en charge est assurée, dans la limite d'une unité par lésion et d'un maximum de deux unités par artère, système de pose compris. La prise en charge est assurée dans les indications suivantes : - sténoses courtes (< 20 mm) des vaisseaux coronaires, quel qu'en soit le diamètre ; - sténoses longues (de 20 à 40 mm) sur des vaisseaux de diamètre supérieur ou égal à 3 mm ; - sténoses de greffons veineux ; - occlusions coronaires totales ; - accidents aigus de l'angioplastie : dissections, occlusions. Dans le cas de dissection occlusive aiguë d'une artère, trois unités au maximum, par artère, peuvent être prises en charge.

NOM DE MARQUE

Code LPP : 3151372

Désignation : ENDOPROTHESE INTRA-HEPATIQUE, GORE, VIATORR TIPS

Dispositifs médicaux implantables d'origine synthétique. Implants vasculaires. Endoprothèse intra-hépatique, Gore, VIATORR TIPS. INDICATIONS PRISES EN CHARGE Traitement des complications de l'hypertension, suivantes : - hémorragies par rupture de varices œsophagiques récidivantes malgré un traitement conventionnel bien conduit réfractaires. - mise en place d'une anastomose intrahépatique transjugulaire de manière précoce dans les 72 h chez les patients échoués au traitement (Child-Pugh classe C < 14 points ou hémorragie en cours au moment de l'endoscopie, des varices œsophagiques de type 1, des varices œsophagiques traitées par traitement initial pharmacologique ou endoscopique. MODALITÉS DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION L'implantation de l'emboliseur doit être réalisée dans des centres possédant un plateau technique d'interventionnelle avec des opérateurs entraînés aux actes hépatiques, y compris les procédures TIPS (Transjugular Intrahepatic Shunt), et disposant d'un environnement médico-chirurgical et entérologique y compris de transplantation hépatique. RÉFÉRENCES PRISES EN CHARGE PT084275, PT085275, PT086275, PT087275, PT105275, PT106275, PT107275, PT108275, PT8104275, PT8107275, PT8108275.

Code LPP : 5188735

Désignation : STENT RETRIEVER, J&J, EMBOTRAP III

Stent retriever, J&J, EMBOTRAP III DESCRIPTION Le dispositif de revascularisation EMBOTRAP III se compose d'un ensemble tridimensionnel en nitinol type stent à l'extrémité distale d'un fil effilé en nitinol. Le dispositif est fourni préchargé dans un outil d'insertion. Le dispositif de revascularisation EMBOTRAP III doit être introduit via un microcathéter d'un diamètre interne (DI) compris entre 0,021" et 0,027". INDICATIONS PRISE EN CHARGE Patients ayant un AVC ischémique à la phase aiguë avec une occlusion proximale d'une artère intracrânienne de gros calibre de la circulation antérieure, visible à l'imagerie dans un délai de 24 heures après la dernière fois où le patient a été vu asymptomatique. Les patients sélectionnés dans un délai de 6 à 16 heures après la dernière fois où le patient a été vu asymptomatique doivent répondre aux critères d'inclusion des études DEFUSE-3 ou DAWN. Les patients sélectionnés dans un délai de 6 à 24 heures après la dernière fois où le patient a été vu asymptomatique doivent répondre aux critères d'inclusion de l'étude DAWN. Le stent retriever EMBOTRAP III doit être utilisé d'emblée en association avec la thrombolyse intraveineuse (IV). Il peut aussi être utilisé en technique de recours après échec d'un traitement par thrombolyse IV ou seul en cas de contre-indication à la thrombolyse IV. MODALITÉS DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION La dimension organisationnelle de la thrombectomie mécanique dans la prise en charge précoce de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu doit être conforme à celle définie dans le rapport " Organisation avec thrombectomie mécanique de la prise en charge précoce de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu ". Conformément au décret n° 2007-366 la thrombectomie doit être entreprise par un spécialiste formé aux procédures de neuroradiologie Interventionnelle dans un centre certifié. Les conditions techniques de fonctionnement et les conditions d'implantation applicables aux activités neuroradiologiques interventionnelles endovasculaires sont précisées dans les décrets suivants : - décret n° 2007-366 du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie et modifiant le code de la santé publique, - décret n° 2007-367 du 19 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie. L'activité neuroradiologique annuelle minimale par site est fixée à 80 interventions endovasculaires portant sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne (arrêté du 19 mars 2007). L'arrêté du 15 mars 2010 fixe les conditions permettant de justifier d'une formation et d'une expérience dans la pratique d'actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie. RÉFÉRENCES PRISES EN CHARGE ET307522 ; ET307537 ; ET307645

Codes d'identification individuelle

Code CIOdm CUFUUXM DM T2A Fiche crée le 08/04/2018

Libellé Cupule mobile automatique Snapfit Ø42 tête-Ø28

LPP Depuis le 01/11/2019

8143070 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE BIOTECHNI

Prix : 286,95 Coefficient : 1 Remboursable Hors-GHS

Indication(s) structurée(s) LPP

- 9999999 - Sans indication spécifique dans la LPP

Historique LPP et Descriptif AMELI »

Période du 21/05/2005 au 31/10/2019

CLADIMED M52CA49 IMPLANT HANCHE CUPULE MOBILE

Hiérarchie »

GMDN

Conditionnement(s) 1. Pièce

BIOTECHNI (Titulaire du Brevet)

Référence fournisseur : C16042

XNOV NEW ORTHOPEDIC VALUE (Distributeur)

Référence fournisseur : C16042

2 fournisseurs mais 1 seul code LPP individuel (celui du fabricant)

Codes LPP en nom de marque

Code CIOdm CN6XMXR   Fiche crée le 30/06/2009

Libellé Insert double-mobilité Mobility (UHMWPE) Ø60/28,0

LPP Depuis le 28/02/2018

3128002 HANCHE, DOUBLE MOBILITE, XNOV, MOBILITY, INSERT, DIAM. 28 MM.

Prix : 83,06 Coefficient : 1 Remboursable Hors-GHS

Indication(s) structurée(s) LPP

- 292 - Arthroplasties de première intention chez les patients ayant un risque de luxation très élevé (atteintes neurologiques sévères, troubles neuropsychiatriques, addictions et grandes défaillances neuromusculaires)
- 293 - Arthroplasties de reprise dans les cas de luxations itératives et chez les patients ayant un risque de luxation élevé

Historique LPP et Descriptif AMELI »

Pas de code LPP individuel pour ce produit car il est inscrit en nom de marque

Historique de rattachement des LPP

Code CIOdm CT89KFN    Fiche crée le 22/06/2016

Libellé Cage lombaire lordotique Juliet OX (stérile) 12° L32 H10

M21 602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS

N.C.H.F.S. 18.28 DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ORTHOPEDIE ET D' OSTEOSYNTHESE

Achat DMS3AD02 CAGE INTERSOMATIQUE FUSION LOMBAIRE

LPP

Depuis le 01/07/2021

8110828 RACHIS, CAGE THOR/LOMB - VERROUILLAGE - SUBSTITUT OSSEUX,SPINEART

Prix : 446,13 Coefficient : 1 Remboursable Hors-GHS

Indication(s) structurée(s) LPP

- 761 - Pathologies dégénératives : discopathie évoluée symptomatique, hernie discale, spondylolisthésis
- 762 - Spondylolisthésis par lyse isthmique symptomatique
- 763 - Déformation rachidienne (scoliose, déséquilibre sagittal et/ou frontal du rachis)
- 764 - Sténose canalairé potentiellement instable et sténose foraminale
- 765 - Traumatologie en cas de nécessité d'une discectomie pour le traitement d'une fracture

Historique LPP et Descriptif AMELI »

Période du 01/11/2019 au 30/06/2021

8115168 RACHIS, CAGE INTERSOMATIQUE OU EQUIVALENT,SPINEART

Prix : 447,71 Coefficient : 1 plus ou pas remboursé

Indication(s) structurée(s) LPP

- 9999999 - Sans indication spécifique dans la LPP

Historique LPP et Descriptif AMELI »

Code LPP applicable
depuis le 1^{er} Juillet 2021

Code LPP applicable
du 01-11-2019 au 30-06-2021

Kits multi-LPP

Code CIOdm CT61XU5 Fiche créée le 24/04/2016

Libellé Plaque Genioplastie 4mm, Vis Auto-Foreuse 2.0mm X 5mm (Q4) Stérile

M21 602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS

N.C.H.F.S. 18.202 DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ORL ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

Achat DM57AB06 PLAQUE PREPLIEE NASALE GENIOPLASTIE

LPP Depuis le 01/11/2019

8129609 IMPLANT CMF, PLAQUE NASALE PREFORMEE, POUR GENIOPLASTIE,OSTEOMED FRANCE

Prix : 122,66 **Coefficient : 1** Remboursable Hors-GHS

Indication(s) structurée(s) LPP

- 9999999 - Sans indication spécifique dans la LPP

Historique LPP et Descriptif AMELI »

8129673 IMPLANT CMF, VIS MICRO, MINI OU MAXI,AUTOFOREUSE OU A AILETTES,OSTEOMED FRANCE

Prix : 51,90 **Coefficient : 4** Remboursable Hors-GHS

Indication(s) structurée(s) LPP

- 9999999 - Sans indication spécifique dans la LPP

Historique LPP et Descriptif AMELI »

Combinaison de codes LPP = 8129609 (X1) + 8129673 (X4)

Suivi des DM Intra-GHS

- [Arrêté](#) et [Note d'information interministérielle](#) du 22 décembre 2021
- Recueil des infos liées à l'utilisation des DM inscrits sur la **liste « Intra-GHS »**
 - Numéro FINESS
 - Numéro administratif de séjour
 - Date d'utilisation
 - **Code IUD-ID** [via lecture code-barres]
 - Nombre d'unités utilisées
- Info **transmises à l'ATIH** via le PMSI

Dans CIOdm

Code CIOdm	CTX981U			
Libellé	MOMENTUM CRT-D Défibrillateur cardiaque implantable connecteur DF-1 LV-1			
Intra-GHS	depuis le 24/12/2021			
M21	602268	Autres DMI		
N.C.H.F.S.	18.22	DISPOSITIFS MEDICAUX POUR CARDIOLOGIE		
Achat	DC50FB05	DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE TRIPLE CHAMBRE		
LPP				
CLADIMED	C50FB05	DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE TRIPLE CHAMBRE		
Hiérarchie »				
GMDN	47270	Défibrillateur implantable de thérapie par resynchronisation cardiaque		
Définition GMDN »				
© Copyright GMDN Agency 2018. Copyright Statement				
Conditionnement(s)	1. Pièce			
BOSTON SCIENTIFIC / SCIMED (Distributeur)				
Référence fournisseur :		Code-barres :		
G126		00802526589157 (GTIN)		

Terminologies du DM

Terminologies

Code CIOdm CU0R792    Fiche créée le 27/08/2017

Libellé Stimulateur cardiaque double-chambre EDORA 8 DR-T ProMRI (télécardiologie) Uni/bipolaire DDDR connexion CLS-IS1

M21 602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS

N.C.H.F.S. 18.22 DISPOSITIFS MEDICAUX POUR CARDIOLOGIE

Achat DC50FA04 STIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE DOUBLE CHAMBRE

CLADIMED C50FA04 STIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE DOUBLE CHAMBRE

Hiérarchie »

- C SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE
- C50 PROTHESE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE
- C50F GENERATEUR D IMPULSION
- C50FA STIMULATEUR CARDIAQUE
- C50FA04 STIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE DOUBLE CHAMBRE

GMDN 47265 Stimulateur cardiaque implantable à chambre double, réactif à la fréquence

Définition GMDN »

Générateur d'impulsions stérile hermétiquement scellé et alimenté par batterie, implanté sous la peau du thorax dans une poche créée par voie chirurgicale, des dérivations de stimulation étant placées dans ou sur deux chambres cardiaques (oreillette droite et ventricule droit). Il est conçu pour stimuler les chambres d'un cœur anormal à l'aide d'impulsions électriques pour qu'elles battent selon leur fréquence naturelle en vue d'ajuster la fréquence de contraction et de répondre ainsi au besoin accru du corps en débit sanguin suite à une activité physique. Il comporte un ou plusieurs capteurs qui détectent les changements dans l'organisme (par exemple, le mouvement, la fréquence respiratoire), signalent un besoin accru en oxygène et, par conséquent, une augmentation de la fréquence de stimulation ; il n'est pas destiné à être utilisé pour le traitement par défibrillation.

Nomenclature Achat et Cladimed

80% des codes Cladimed ont une correspondance dans la nomenclature achat

Code Achat = « D » + Code Cladimed (e.g. DC50FA04 existe)			
Code CIOdm	CU0R792	DM T2A	
Libellé	EDORA 8 DR-T Stimulateur cardiaque implantable DDDR avec télécardiologie connecteur IS1+Cardio Messenger		
CLADIMED	C50FA04		STIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE DOUBLE CHAMBRE
	Hiérarchie »		
N.C.H.F.S.	18.22		DISPOSITIFS MEDICAUX POUR CARDIOLOGIE
Achat	DC50FA04		STIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE DOUBLE CHAMBRE

20% des codes Cladimed n'ont pas de correspondance dans la nomenclature achat

Code Achat ≠ « D » + Code Cladimed (e.g. DF52GA01 n'existe pas)			
Code CIOdm	AMFFA9R		
Libellé	ELECTRODE MONOPOLAIRE AIGUILLE UU stérile Ø0,7*19mm*2,35mm L50mm		
CLADIMED	F52GA01		INSTRUMENT ELECTROCHIRURGIE MONOPOLAIRE AIGUILLE
	Hiérarchie »		
N.C.H.F.S.	18.312		DISPOSITIFS MEDICAUX d'INSTRUMENTATION
Achat	DF52AZ99		INSTRUMENTATION AUTRE

Nomenclature Achat et NCHFS



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rechercher

Actualités/Presse | Grands dossiers | Ministère | Métiers et concours | **Professionnels** | Etudes et statistiques

Affaires sociales | Prévention en santé | Santé et environnement | Soins et maladies | Système de santé et médico-social

Accueil > Professionnels > Gérer un établissement de santé / médico-social > Performance des établissements de santé > Le programme PHARE Une transformation de l'achat hospitalier au service du (...) > Les chantiers opérationnels > La structuration de l'information achat

La structuration de l'information achat

A+ A- [Print]

[Email] [Twitter] [Facebook]

La nomenclature achats

La mise en place de fonction achat mutualisées au sein des 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT) a permis depuis le 1er janvier 2018 d'approfondir et d'encourager les coopérations entre établissements. La nécessaire collaboration entre tous les établissements du GHT implique un **partage lisible des informations** concernant les **processus d'achat et les marchés** afin notamment de permettre à l'établissement support d'assumer la délégation sur le plan des achats qui lui est confiée et d'en rendre compte aux autres établissements membres.

Dans cette rubrique

- La fonction achat de GHT
- Le pilotage de la performance achat
- Les achats innovants

PDF Guide nomenclature Téléchargement (1.3 Mo)

XLSX **Nomenclature achat DGOS** Téléchargement (1.8 Mo)

<https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/phare-11061/les-chantiers-operationnels/article/la-structuration-de-l-information-achat>

Nomenclature Achat et NCHFS


MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
*Liberté
Égalité
Fraternité*

[Actualités/Presse](#) | [Grands dossiers](#) | [Ministère](#) | [Métiers et concours](#) | **Professionnels** | [Etudes et statistiques](#)

[Affaires sociales](#) | [Prévention en santé](#) | [Santé et environnement](#) | [Soins et maladies](#) | [Système de santé et médico-social](#)

[Accueil](#) > [Professionnels](#) > [Gérer un établissement de santé / médico-social](#) > [Performance des établissements de santé](#) > [Le programme PHARE Une transformation de l'achat hospitalier au service du \(...\)](#) > [Les chantiers opérationnels](#) > **La structuration de l'information achat**

La structuration de l'information achat

[A+](#) [A-](#) 





Dans cette rubrique
[La fonction achat de GHT](#)
[Le pilotage de la performance achat](#)

Nomenclature achat	Produit élémentaire (N-5)	Code Catégories Homogènes Fournitures et Prestations	Libellé des Catégories Homogènes de fournitures et prestations	Compte comptable (à titre indicatif)
DA52AA01	SONDE GASTRODUODENALE SIMPLE COURANT	18.21	DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ABORD DIGESTIF	602222
DA52AA02	SONDE GASTRODUODENALE DOUBLE COURANT	18.21	DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ABORD DIGESTIF	602222
DA52AA03	SONDE GASTRODUODENALE SIMPLE COURANT AIMANTEE EXTREMITE FERMEE	18.21	DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ABORD DIGESTIF	602222
DA52AA04	SONDE GASTRODUODENALE SIMPLE COURANT AIMANTEE EXTREMITE OUVERTE	18.21	DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ABORD DIGESTIF	602222
DA52AC01	TUBE LAVAGE GASTRIQUE	18.21	DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ABORD DIGESTIF	602222
DA52AD01	SONDE INTESTINALE	18.21	DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ABORD DIGESTIF	602222
DA52DA01	SONDE RECTALE	18.21	DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ABORD DIGESTIF	602222
DA52DB01	SET A LAVEMENT	18.21	DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ABORD DIGESTIF	602222
DA52Z39	TRACTUS DIGESTIF ASPIRATION IRRIGATION AUTRE	18.21	DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES POUR ABORD DIGESTIF	602222


Installation et mise à jour dans les applications du SIH

Logiciels « CIOdm Inside »


Advance (Softway Medical)	ERP Sano v3 (2CSi)	Pharmalog version 6.6 (KLS Logistic)
Pharma / Bloc (Computer Engineering)	Génois-Sillage (SIB)	Qualiac (Cegid)
Copilote (Maincare)	MAGH2 / PRODIGE (MIPIh)	SAP (Service de Santé des Armées)
CPage-Economat (Cpage)	MEDIANE GEF (MEDIANE)	Scout-DM (QSP Systems)
DxCare / DxPharm / DxBloc (Dedalus)	Optim OPM (Nexus France)	TimeWise (Canyon Technologies)

CAT si un logiciel n'est pas compatible ou n'intègre pas toutes les données requises ?



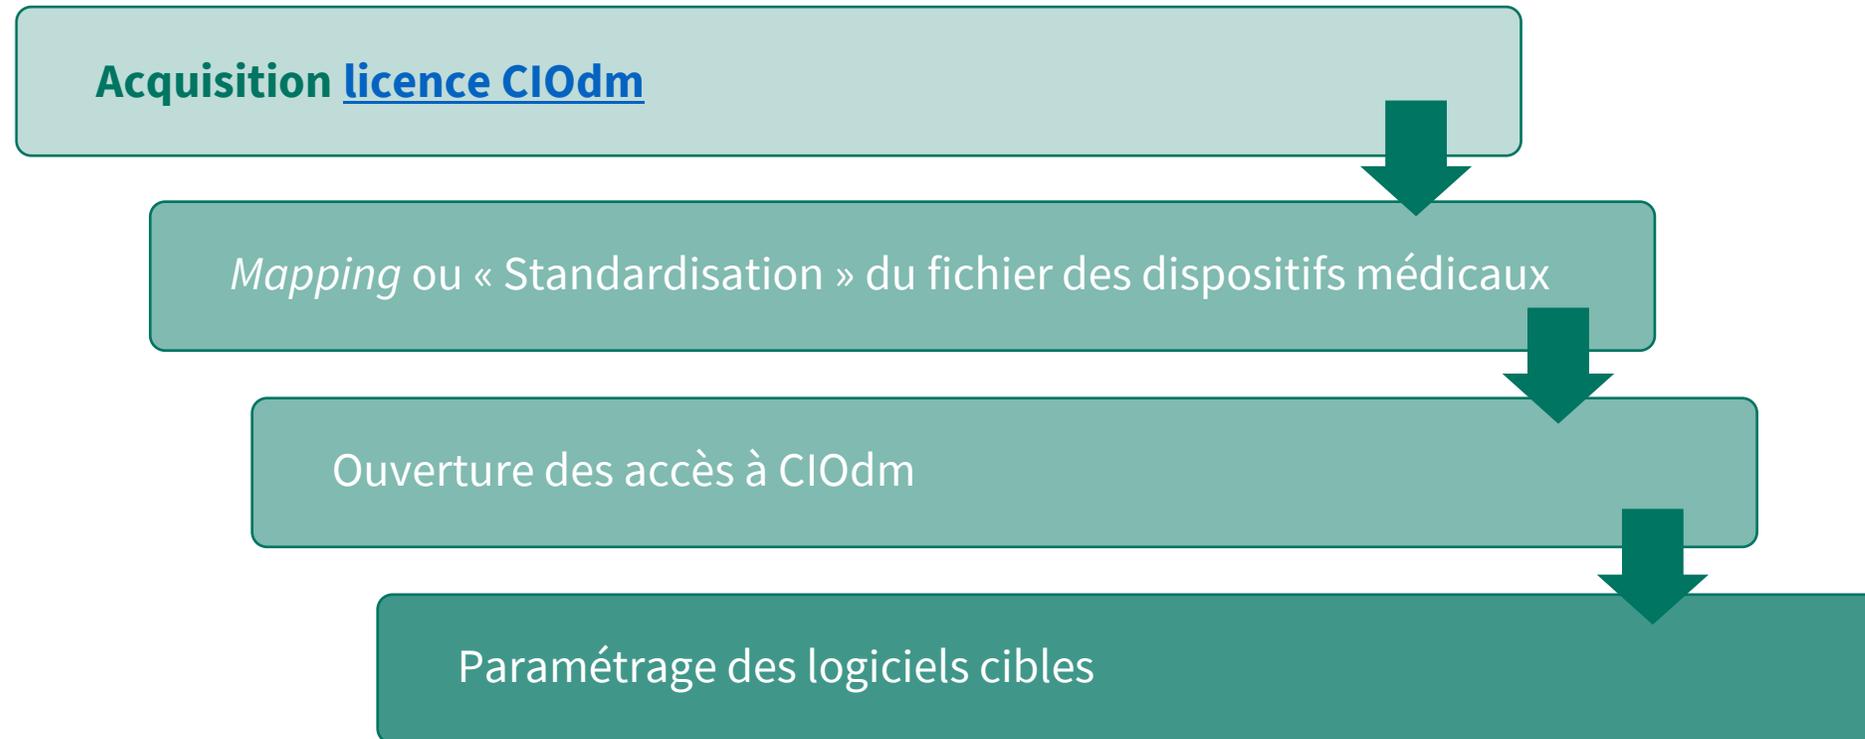

Mapping

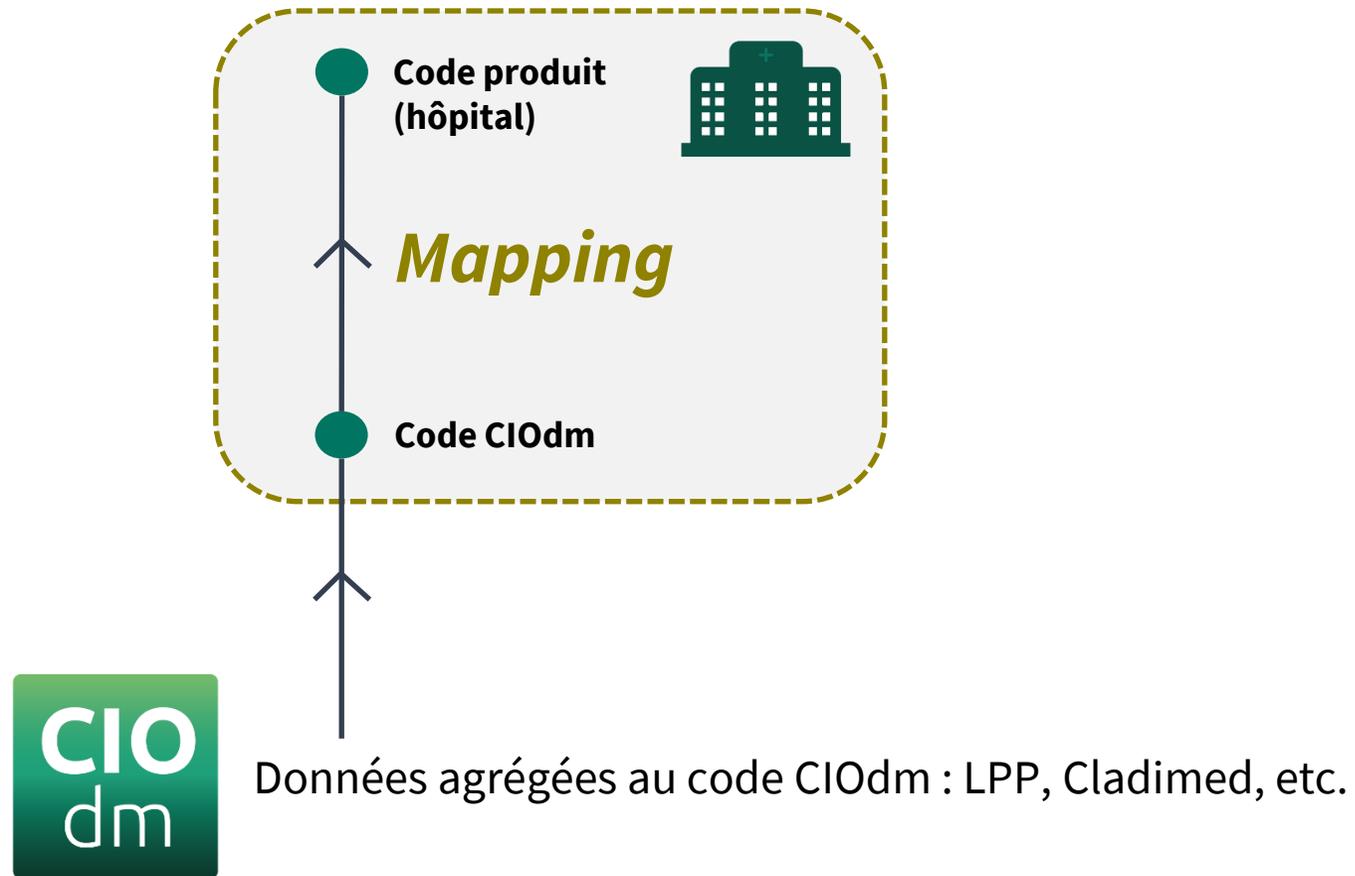

Etapes du mapping



= Codes CIOdm

codint Ets	REF Ets	Libellé produit1 Ets	Fournisseur Ets	Remarque Mapping	ArtidCIO	REF CIO	Libellé produit CIO
15834	QCS18-15	AIGUILLE BIOPSIE 18G 15MM ref QCS 18-15.0-20T	THE SURGICAL COMP	1) dbl01	AE6UFF3	QCS-18-15.0-20T	AIGUILLE BIOPSIE COAXIALE SEMI-AUTOMATIQUE GUILLOTINE Ø18G L15cm L-COURSE 20mm
4581		AIGUILLE BIOPSIE RENALE COAXIALE 18G 15CM QCS 18-15.0-20T	THE SURGICAL COMP	1) dbl01	AE6UFF3	QCS-18-15.0-20T	AIGUILLE BIOPSIE COAXIALE SEMI-AUTOMATIQUE GUILLOTINE Ø18G L15cm L-COURSE 20mm
10908		CATHETER GUIDE PR PTCA 7F JR4 LAUNCHER ref LA7JR40	MEDTRONIC FRANCE	1) dbl02	AN29711	LA7JR40	CATHETER LA 7F 100cm JR40
15891		CATHETER GUIDE PR PTCA 7F JR40 LAUNCHER réf LA7JR40	MEDTRONIC FRANCE	1) dbl02	AN29711	LA7JR40	CATHETER LA 7F 100cm JR40
13383		STIMULATEUR CARD MONO SSIR ASSURITY SR IRM ref PM1272	ABBOTT MEDICAL FRA	2) mapping à contrôler	CRURCOK	PM1272	ASSURITY MRI Stimulateur cardiaque implantable SSIR (avec télésurveillance)
3315		NYLON 0.3 9/0 3/8 SPAT réf 198101	ALCON	2) mapping à contrôler	AE4FARR	1981	Suture nylon Spatulée 3/8 cercle - 9/0 (Dec.0.3) - 30 cm
1968		APPAREIL DIURESE HORAIRE 1.10 M réf UM158100510190 500mL	AMBU SARL	2) mapping à contrôler	CN6XR8F	158100510190	Diurèse Horaire Unomedical - Unometer Safeti Plus - 2 valves anti-retour - avec crochet - et
3460		SACHET PEL PAP/POLYM 220 X 450 réf 01BOPS22045	SPS MEDICAL (EX AM	2) mapping à contrôler	EA2MX49	01BOP22045	SACHET PELABLE SI BOP EMB 220*450mm
2882	N7200	TUBULURE IRRIGATION VESICALE POUR RTU EN Y ref 202126	ASEPT IN. MED SA	2) mapping à contrôler	CR6H6HF	202126	NECESSAIRE IRRIGATION 2 VOIES CHAMBRE RIGIDE UNIRIG
16485	5972065	PROTHESE GENOU NEXGEN SEGMENT DIAPHYSAIRE ref 00-5852-040-35	ZIMMER BIOMET FRA	2) mapping à contrôler	CR6E7KM	00-5852-040-35	SEG TM COLLAR, FOR 9-16MM,35MM
16471		DISPOSITIF PR INCONTINENCE URINAIRE TVT SWIFT SLING 500 EJB DS500091	2F SURGICAL	3) mapping ok	CTKXT1K	0370045840271	SWIFT SLING Bandelette sous-urétrale Implant + aiguille grande courbure (SWIFT SLING + UG
16432		DISPOSITIF PR INCONTINENCE URINAIRE TOT SWIFT SLING 500 EJB DS500031	2F SURGICAL	3) mapping ok	CTKXT0M	0370045840270	SWIFT SLING Bandelette sous-urétrale Implant + aiguilles hélices gauche-droite + guide (SW
15179		STENT CORONAIRE A LIB. DE PRINC. ACT 2.25 X 8 XIENCE SIERRA ref 1500..	ABBOTT MEDICAL FRA	3) mapping ok	CUFK63E	1500225-08	XIENCE Sierra Stent coronaire actif L08mm*Ø2,25mm Elution Everolimus
15185		STENT CORONAIRE A LIB. DE PRINC. ACT 2.50 X 08 XIENCE SIERRA ref 1500..	ABBOTT MEDICAL FRA	2) mapping ok		1500250-08	XIENCE Sierra Stent coronaire actif L08mm*Ø2,50mm Elution Everolimus

1 - Export fichier produits (Etablissement)

2 - Mapping avec CIOdm (PHAST - délai 4-6 semaines)

3 - Fichier de mapping transmis à l'établissement

4 - Fichier de mapping contrôlé par la PUI (cf. remarques laissées par PHAST)

5 - Transmission au service informatique et/ou éditeur pour intégration dans logiciels cibles

Accès à CIOdm : 2 modes

Fichiers .txt



Utilisation de CIOdm au quotidien



- Mapping des nouvelles fiches : recherche du code CIOdm
 - Dans l'interface du logiciel
 - Dans la visionneuse CIOdm
- Questions sur le contenu de CIOdm
 - Contacter PHAST
- Questions sur l'utilisation de CIOdm dans les logiciels
 - Contacter le service informatique de l'établissement
 - Contacter PHAST en cas de problème lié à TelCIO ou STS
 - Contacter l'éditeur pour tout autre type de problème

Support aux établissements

Quels outils ?



PHAST



Demandes de création

Signalements qualité

VISIONNEUSE CIO DM

Guide hôpitaux

https://www.phast.fr/wp-content/uploads/2021/09/PHAST_Guide-Visionneuse-CIOdm-2021.pdf

Quels outils ?



Demandes de création

Signalements qualité

Ajout de codes IUD-ID

SERVICE ÉCHANGE

Plaquette hôpitaux

<https://www.phast.fr/wp-content/uploads/2023/01/Flyer-Service-%C3%A9change-2022.pdf>

Quels outils ?

Pour toutes autres demandes : CIOdm@phast.fr



PHAST

www.phast.fr

ciodm@phast.fr